

注意事项:

1. 资格审核通过后, 请登录系统个人中心, 左下角扫二维码(必须登陆后扫码), 申请进入钉钉群;
2. 入群申请两个工作日后未通过, 请致电报名页面最下方, 招标采购中心联系方式提供的电话;
3. 请务必安排负责项目人员入群, 方便及时接收相关通知、后期办理各项事务。

南昌大学第二附属医院 · 投标平台

12:05 46

星期三
2021年10月13日

武汉科技有限公司

首页

退出

我的项目

企业信息

采购项目名称

查询

序号	采购项目名称	报名情况	现场报价码	开标时间	投标文件编制说明	投标文件	现场报价表	中标情况
1	骨科多功能影像等	已通过	000879	2021-10-11 10:03:02	下载	预览	预览	/
2	腹腔镜系统等	已通过	001158	2021-10-09 16:44:22	下载	预览	预览	/
3	维达纸巾等	已通过	004594	2021-10-09 16:27:13	下载	预览	预览	/
4	PET-CT	已通过	000571	2021-10-10 00:00:00	下载	上传	/	/
5	腹腔镜系统	已通过	000972	2021-10-08 16:38:12	下载	上传	/	下载中标通知书
6	2310	已通过	004046	2021-10-08 17:44:35	下载	预览	预览	/
7	MRI	已通过	003696	2021-09-30 11:38:53	下载	预览	预览	中标
8	腹腔镜系统	已通过	005101	2021-09-28 09:16:50	下载	预览	预览	下载中标通知书
9	内窥镜	已通过	000894	2021-09-27 16:17:34	下载	预览	预览	/
10	无痛人流	已通过	003732	2021-09-27 15:39:11	下载	预览	预览	/

共 152 条

1

2

3

4

5

6

...

16

前往

1

页



南昌大学第二附属医院
招标采购中心钉钉群

非正文，此页可删

调研文件

采购编号：_____

项目名称：_____

品 牌：_____

产 地：_____

报名单位：_____

联 系 人：_____

联系电话：_____

报名时间：_____

盖 章：_____

南昌大学第二附属医院招标采购中心

目录

01.附件 1：投标申请人致函 7

02.附件 2：授权书8

03.附件 3:承诺函 9

04.附件 4：中小企业声明函 10

05.报价单（注：需按照项目类型填入对应的报价单） 12

06.投标人资质、代理资质、厂家资质 15

07.产品资质15

08.项目需求（需对照需求及评标标准制作响应偏离文件） 18

09.评标标准 错误！未定义书签。

10.响应偏离文件42

文件编制要求

1. 采购/调研文件的组成和要求

1.1 投标人应报送的采购/调研文件的具体内容和编排顺序如下：

- (1) 采购/调研文件封面；
- (2) 采购/调研文件总目录或索引（总目录或索引格式由申请人自行设计）；
- (3) 投标人致函（附件1）；
- (4) 由投标人法定代表人为授权委托人签署（签字或盖章）颁发的授权书（附件2）；
- (5) 投标人法定代表人和授权委托人身份证的正反面复印件加盖公章；
- (6) 投标人须提供企业营业执照（含税务登记证、组织机构代码证）、医疗器械经营备案凭证等证件复印件加盖公章；
- (7) 投标人须提供售后服务能力证明材料（南昌地区）原件；
- (8) 如果投标人所投的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书（复印件加盖公章）；如为经销授权，投标人需提供有效的经销授权书（复印件加盖公章）。
- (9) 如代理的产品为进口产品，投标人还须提供国外企业中国分公司企业营业执照（含税务登记证、组织机构代码证），复印件加盖公章；从设备到货验收合格之日起，需提供两年或以上质保期。所投设备如有专机专用的耗材，必须标明并附耗材清单。
- (10) 如代理的产品为国产产品，投标人须提供国内生产企业营业执照（含税务登记证、组织机构代码证），医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证（复印件加盖公章）；（若该产品行业内不具备可不提供）；从设备到货验收合格之日起，需提供三年或以上质保期。所投设备如有专机专用的耗材，必须标明并附耗材清单。
- (11) 耗材类如纳入医疗器械管理的，必须具有相应的备案凭证或注册证（如医疗器械备案凭证、医疗器械注册证等）；可收费类需提供江西省药品和医用耗材招采管理系统（网址：

<https://ggfw.ybj.jiangxi.gov.cn/#/Index>) 及国家医保信息业务编码标准数据库动态维护官网 (网址:

<https://code.nhsa.gov.cn/toSearch.html?sysflag=1004>) 截图, 截图示例见文件编制补充说明; 不可收费类需提供江西省药品和医用耗材招采管理系统 (网址:

<https://ggfw.ybj.jiangxi.gov.cn/#/Index>) 截图, 截图示例见文件编制补充说明。

- (12) 所投产品资格文件包含: 二类、三类医疗器械需包含医疗器械生产产品登记表、医疗器械注册证 (含附件) 等 (复印件加盖公章); 一类医疗器械需包含备案凭证、备案信息表及网页截图等 (复印件加盖公章); **非医疗器械管理产品需出具国家药品监督管理局 (网址: <https://www.nmpa.gov.cn/index.html>) 非医疗器械管理说明等 (复印件加盖公章)。**

- (13) 所投产品如需与医院系统对接, 投标人需承担所有对接费用。

- (14) 承诺函 (附件 3)

- (15) 投标人认为有必要提供的其他资料, 如产品参数、配置、彩页、等;

- (16) **产品授权期自授权日期起必须超一年 (含一年)。**

- (17) **中小企业声明函 (附件 4)**

- 1.2 投标人提交的采购/调研文件应客观、属实。如投标方无故不参加投标活动或迟到 2 次以上 (1 年内)、提供虚假材料、近三年内经营活动中有严重违法记录、采取不正当手段诋毁或排挤其它供应商、恶意串通或行贿、拒不签订或不如实履行采购合同、无事实依据恶意投诉, 或有其它违法违规行干扰招标活动的, 招标人有权取消投标申请人的投标资格, 并将该投标厂商列入供应商黑名单, 3 年内不得参与我院任何采购项目投标。如果招标人因此遭受损失, 投标人应予以赔偿, 并且承担相应的法律责任。

2. 采购/调研文件的形式和签署

- 2.1 采购/调研文件: 电子文件应扫描已加盖公章文件; 纸质文件应加盖公章, 左侧装订或胶装 (如果申请文件太厚, 可以分册装订), 装订方式应牢固、美观, 不得采用活页方式装订。

3. 采购/调研文件的递交审核

- 3.1 投标人应在规定的时间内, 在南昌大学第二附属医院采购管理平台网

站上传资料（网址：<https://bid.jxndefy.cn/home>）。

- 3.2 招标人有权拒绝接收在本条规定的截止时间以后收到的以及未递交到本条规定网站或地点的任何采购/调研文件，被拒绝的采购/调研文件将原封退还投标申请人。

- 3.3 投标人采购/调研文件申请通过后，本项目以投标人在南昌大学第二附属医院采购管理平台网站（网址：<https://bid.jxndefy.cn/home>）上传的采购/调研文件为依据进行评审。

仅当南昌大学第二附属医院采购管理平台网站（网址：<https://bid.jxndefy.cn/home>）出现故障情况下，按投标人递交的纸质采购/调研文件为依据进行评审。未递交纸质采购/调研文件的投标人，按无效处理。

- 3.4 投标人应准备一份采购/调研文件正本和六份副本，每套采购/调研文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

4. 项目技术参数（所投项目完全符合或满足临床要求）

- 5 评审办法

- 6 注意事项

- 6.1 当事人认为采购/调研文件、议价过程和成交结果使自己权益受到损害的，应当在以下规定时间内以书面形式向招标采购中心提出质疑。

(1) 对采购/调研文件提出质疑的，为资格审核通过之日起三日内，超出规定时间不予受理。

(2) 对议价过程提出质疑的，为各议价程序环节结束之日起三日内，超出规定时间不予受理。

(3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公示期限届满之日，超出规定时间不予受理。

02.附件 2：授权书

授权书

本人_____（身份证号：_____），作为（公司名称）_____法定代表人，在此授权我公司_____先生/女士（身份证号：_____）作为我公司正式合法的代理人以我公司名义并代表我公司全权处理_____（项目编号及名称）招投标业务办理及合同签订等相关事宜。

本授权书限期自_____起至_____止。（起始时间应为项目发布之日后，授权期需一年以上。）

在此授权期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

_____（公司名称及公章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

授权人身份证复印件正面	授权人身份证复印件反面
被授权人身份证复印件正面	被授权人身份证复印件反面

03.附件 3:承诺函

承诺函

南昌大学第二附属医院：

我公司郑重承诺在本次采购活动中，所提交的材料是真实、有效的，复印件与原件一致的。

不存在借用、挂靠资质，围标、串标等违法违规行为；不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下采购活动的情况；不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动的情况。

如隐瞒有关情况或提供任何虚假材料，我公司自行承担一切法律后果。我公司将自觉接受采购人、其他供应商、广大群众监督，若发生违诺行为，自愿接受任何处罚。

_____（公司名称及公章）

承诺人（签字、盖章）：

日期：

04.附件 4：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院第728号）的规定，本公司参加南昌大学第二附属医院的（项目编号、项目名称）议价活动，本企业为符合政策要求的中小企业。本企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业行业；本企业从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业行业；本企业从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

本企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院第728号）的规定，本公司参加南昌大学第二附属医院的（项目编号、项目名称）议价活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。本企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于_____行业；本企业从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业行业；本企业从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

本企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

05.报价单（注：需按照项目类型填入对应的报价单）

注：设备报价表头

项目名称及编号

序号	产品注册证 名称(或备案 名称)	生产企业全 称	规格型号	产品注册证 号(或备案 号)	数量	单位	单价(元)	总价(元)	质保期	备注
							报名(资格审 核时)此项不 填	报名(资格审 核时)此项不 填		需填写是否 已有同型号 产品在院使 用,写明采购 单价,使用科 室及起始年 度。

承诺：报价单内所填信息真实有效，产品信息与注册证（或备案凭证）信息完全一致，如信息有误后果自负；所投产品如需与医院系统对接，承担所有对接费用。

单位：

日期：

注：耗材类报价表头

项目名称及编号

序号	产品注册 证名称 (或备案 名称)	生产企 业全称	规格型 号	产品注册 证号(或 备案号)	每人份报 价(元)	最小供 货单位	单价(元)	江西省 挂网 ID	江西省平 台参考价 (元)	收费编 码及名 称	收费金额 (元)	国家医保 耗材分类 编码	备注
							报名(资格 审核时)此 项不填						需填写是 否已有同 型号产品 在院使 用, 写明 采购单 价, 使用 科室及起 始年度。

承诺：报价单内所填信息真实有效，报价表内提供信息与注册证（或备案凭证）、江西省药品和医用耗材招采管理系统及国家医保信息业务编码标准数据库动态维护官网内容完全一致，如信息有误后果自负。

单位：

日期：

注：非医疗器械管理产品报价表头

项目名称及编号

序号	产品彩页或 外包装产品名称	生产企业全称	规格型号	产品注册证 号（或备案号）	数量	单位	单价（元）	总价（元）	质保期	备注
				非医疗器械 管理			报名（资格审 核时）此项不 填	报名（资格审 核时）此项不 填		需填写是否 已有同型号 产品在院使 用，写明采购 单价，使用科 室及起始年 度。

承诺：报价单内所填信息真实有效，产品信息与注册证（或备案凭证）信息完全一致，如信息有误后果自负；所投产品如需与医院系统对接，承担所有对接费用。

单位：

日期：

06.投标人资质、代理资质、厂家资质

1. 投标人营业执照
2. 投标人经营许可证
3. 投标人经营备案凭证

4. 代理营业执照
5. 代理经营许可证
6. 代理经营备案凭证

7. 厂家营业执照
8. 厂家经营许可证
9. 厂家经营备案凭证

07.产品资质

1. 产品授权书
2. 产品备案信息表
3. 产品注册证

注：需含注册证附件

如为非医疗器械类需出具国家药品监督管理局（网址：
<https://www.nmpa.gov.cn/index.html>）非医疗器械管理说明等（复印件加盖公章）

4. 产品配置清单

注（模版见下页）：

医疗器械类需包含产品注册证（或备案凭证）内的产品名称及型号规格；

非医疗器械类需包含彩页或产品外包装的产品名称及型号规格；

文件内容错误将导致后续无法验收入库。

5. 产品参数及特点

6. 产品售后服务

7. 产品彩页

8. 产品图（外包装及产品实拍图）

注：

特别是非医疗器械管理类以及耗材类项目，未提供此信息将导致后续无法验收入库。

9. 投标人认为有必要提供的其他资料

XXXXXX 配置清单模板（单台标配）

项目名称：XXXXXXXXXXXXXXXXX 项目编号：XXXXXXXXXXXXXXXXX

产品名称：XXXXXXXXXXXXXXXXX 规格型号：XXXXXXXXXXXXXXXXX

序号	产品名称	规格型号	单位	数量
1	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X
2	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X
3	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X
4	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X
5	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X
6	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X
7	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X
8	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X

注：

医疗器械类需包含产品注册证（或备案凭证）内的产品名称及型号规格；

非医疗器械类需包含彩页或产品外包装的产品名称及型号规格；

文件内容错误将导致后续无法验收入库。

南昌大学第二附属医院国家区域医疗中心一期标识标牌采购项目

一、项目名称

南昌大学第二附属医院国家区域医疗中心一期标识标牌采购项目

二、项目内容

国家区域医疗中心一期标识标牌清单见附件1。采购清单中所列货物数量为预估数量，实际使用数量以项目验收数为准。

三、合同履行期限

合同履行期限：自合同签订之日起2年或项目总金额执行完毕时合同自动终止。

四、项目预算

1、投标人根据项目采购清单报价，最高限价为人民币 1594936.34 元；如投标人的投标报价高于最高限价，投标将被否决。

2、投标人要按项目清单(统一格式)的内容填写单位、单价及其他事项，并由投标人盖章及法定代表人或授权代表签署。

3、投标报价是指该项目项下所有供货、安装、调试、验收、运输、安装、拆除、各类税费及其他一切与该项目相关费用总和。

4、投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。

5、本项目为院内调研，不作为中标结果。

五、投标人资格：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；
- 6、本项目不接受联合体报价，中标后不允许转包。

六、产品质量保证和售后服务

1、投标人所提供的产品及安装符合规定的各项要求，如发现质量不符或服务不到位，医院有权拒绝接收，由此产生的损失由中标人 承担。

2、投标人保证确认货物因装卸、运输、安装中发生损坏或短缺 后，在采购人指定期限内给予调换和补齐缺件至采购人满意为止，不 管其造成的原因如何，均不能因为以办理索赔为由而拖延。无论在质 保期内还是质保期满后，中标人负责对其实施的项目提供现场服务。

3、投标人必须对医院提出的制作需求及时响应，能按时完成设 计、制作与安装，对于分批次制作安装等零星需求，不得以数量少等 理由拒绝或拖延制作。合同执行期间，如中标人累计 3 次因不能按 时完成制作遭采购人使用部门投诉的，采购人有权终止与其合作。

4、质保期：3 年。在质保期内，中标供应商提供更换或维修服务， 由此产生的费用由中标供应商承担。

七、验收

1、采购人按实际需要量分批制作安装，中标人接采购方的发货通知后，应按要求在规定时限内将相应货物按要求的数量及时送达指定的地点。

2、送货后由采购人使用部门负责进行检查验收，如果发现数量不足或有质量等问题，中标人应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

八、付款方式

1、合同签订后，30个工作日内，可一次性支付项目总额度的30%作为预付款。

2、按照实际制作数量，每季度审核中标方的制作清单无误，并经验收审计完成后，按照中标单价一季度一结原则据实结算。预付款作为货物结算款的一部分，当实际产生货物款项小于预付款时，由预付款进行冲抵；当实际产生货物款项大于预付款时，可继续支付剩余实际货物款项。

3、发票章单位名称必须与投标时公章名称相符合，否则医院有权拒付相关款项。

4、采购人付款前，中标人应先向采购人开具相应金额的税务发票，否则采购人不承担由此造成的延期支付责任。

九、风险承担与责任认定

1、中标人的工作人员工伤风险，由中标人自行承担。

2、因意外事故或作业安全问题引发的人身伤亡和财产损失，中

标人依法承担赔偿责任。

3、治安事件的责任认定，以公安部门裁定为准；非治安事件的责任认定，由双方协商，协商不成的，以诉讼或仲裁方式认定。

4、中标人在服务作业过程中由于操作不当造成的采购物价损坏，验收时采购人可拒绝签收，费用由中标人自行承担。

十、其他要求

投标样品的设计、制作、运输等一切费用由投标公司自理，采购人
不作任何补偿。

十一、评标办法及评分细则

本项目采用综合评分法，满分 100 分。评分细则如下：

(一) 价格部分 (30 分)		
评分点	评审内容	分值
报价	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$ 注：对小型、微型企业和监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，投标人同属以上优惠类型企业的，不重复享受政策优惠。	30 分
(二) 技术部分 (55 分)		
评分点	评审内容	分值
技术要求	投标人必须完全满足招标文件第五章采购需求“技术要求”实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：技术要求响应/偏离表。	/
专业	1、投标人为本项目配备 4 人(含)及以上专业服务团队得 4	24 分

团队	分, 配备 8 人(含)及以上专业服务团队得 8 分, 最高得 8 分。 评审依据: 投标文件中需提供拟投入本项目团队人员名单一览表、对应人员身份证号码、劳动合同, 以及提交投标文件截止时间前 6 个月内任意 1 个月在投标人为其缴纳的纳社保凭证并加盖投标人公章佐证, 缺项漏项不得分。 2、团队人员中(同一人员不重复计分): ①每一人具有本科及以上学历高级平面设计师证书的得 2 分, 最高得 4 分。 ②每一人具有焊接与热切割作业证的得 2 分, 最高得 4 分。 ③每一人具有电工作业证的得 2 分, 最高得 4 分。 ④每一人具有高空作业证的得 2 分, 最高得 4 分。 评审依据: 投标文件中需提供上述人员对应证书原件的扫描件 并加盖投标人公章佐证及投标文件截止时间前 6 个月内任意 1 个月在投标人为其缴纳的社保凭证并加盖投标人公章佐证。	
制作设备	投标人具有标识标牌生产制作所需的条幅机、高清写真机、UV 平面打印机、雕刻机、钣金液压折弯机、钣金液压剪裁机, 光纤切割机、激光(平面)切割机、高速复印机设备、高清喷绘机, 每提供 1 种设备得 2 分, 最高得 16 分。(含名称表述差异, 但功能类似的设备) 评审依据: 如为投标人自有设备: 提供设备照片、购买发票(购买人为投标人); 如为投标人租赁设备: 提供设备照片、租赁合同、购买发票(购买人为出租方); 提供以上资料。	16 分
亚克力板	须满足 GB/T 7134-2008 标准, 板材的表面平滑。板材中未发现大于 3mm 的划痕、斑点或其他表面缺陷; 颜色分布均匀, 色泽一致。拉伸断裂应变的范围$\geq 5\%$, 加 3 分。 评审依据: 提供第三检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件佐证。 拉伸弹性模量的范围$\geq 5000\text{MPa}$ 加 1 分。 评审依据: 提供第三检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件佐证。	15 分



PVC 发 泡 板	须满足 GB/T1033.1-2008 标准，颜色均匀，样品表面无气泡，无裂无明显裂纹，无凹陷，无杂质，密度$<500\text{kg}/\text{m}^3$ 的加 2 分。 评审依据：提供第三检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件佐证。	
铝单板	须满足 GB/T23443-2009 标准，板材边部切齐无毛刺、裂边板材无开焊等。外观整洁，色泽基本一致，无明显划伤。装饰面 无明显压痕、印痕和凹凸等残迹。无明显色差。涂层无流痕、 裂纹、气泡、夹杂物和其他表面缺陷，铅笔硬度$\geq 2H$ 的加 2 分。 评审依据：提供第三检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件佐证。	
	耐磨性$\geq 5L\ \mu\text{m}$ 的加 3 分。 评审依据：提供第三检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件佐证。	
锌 黄 环 氧 漆	须满足 GB/T26125-2011、GB/T29786-2013 标准，铅$<50\text{mg}/\text{kg}$、镉$<50\text{mg}/\text{kg}$、六价铬$<50\text{mg}/\text{kg}$、汞$<50\text{mg}/\text{kg}$，每满足 1 项指标加 1 分，最多加 4 分。 评审依据：提供第三检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件佐证。	
(三) 商务部分 (15 分)		
评分点	评审内容	分值
商务 要求	投标人必须完全满足招标文件第五章采购需求“商务要求”实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：商务要求响应/偏离表。	
业绩	投标人自 2023 年 1 月 1 日至今 (以合同签订时间为准) 具有同 类 (标识标牌) 项目业绩的，每提供一份业绩得 2 分，最多得 10 分。 评审依据：商务要求响应/偏离表。	10 分
售后 服务	售后服务响应时间包含周末、节假日，提供 7*24 小时服务响应得 2 分。 评审依据：投标文件中需提供服务承诺函 (格式自拟) 并加盖	2 分

	投标人公章。	
质量 保证	在满足基本要求质保期 3 年前提下, 投标人每增加 1 年质保期的加 1 分, 本项最多加 3 分; 评审依据: 投标文件中需提供质保期承诺函(格式自拟)并加盖投标人公章。	3 分

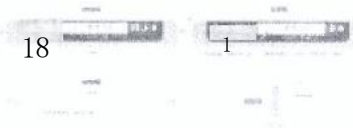
评分说明: 1、评委根据评标情况逐栏打分, 每栏分值不得超出本栏规定的分值范围; 2、各评分因素项分值保留小数点后两位; 3、投标人根据要求如实提供佐证材料。


附件 1:国家区域医疗中心一期标识标牌采购清单、项目实施标准及要求


(一) 清单

导视等级	序号	名称	数量 (个)	材质	尺寸 (毫米)	图例	单位	单价 (元)	含税总价 (元)	备注
一级导视	1	医院入口形象导视墙	1	面层 2mm 厚 304 不锈钢板激光切割造型，基础及装饰造型焊接，文字激光雕刻镂空内衬 5mm 厚亚克力，内置 LED 防水光源，内部钢架结构焊接，做环氧防锈底漆，立体字采用不锈钢树脂发光字立体焊接；整体做防锈底漆三遍，刮原子灰打磨至光滑程度，面饰品牌汽车漆两遍(木纹烤漆工艺处理及蓝色面漆处理)安装钢架基脚焊接，做防锈处理，整体厚度 150 公分。	8000*2870		套	32172.7	32172.70	
	2	户外道路指引牌	2	面层 1.5mm 厚 304 不锈钢板激光切割造型，基础及装饰造型焊接，文字激光雕刻镂空内衬 5mm 厚亚克力，内置 LED 防水光源，内部钢架结构焊接，做环氧防锈底漆；整体做防锈底漆三遍，刮原子灰打磨至光滑程度，面饰品牌汽车漆两遍(木纹烤漆工艺处理及蓝色面漆处理)安装钢架基脚焊接，做防锈处理，整体厚度 10 公分。	1000*2400		套	5605.00	11210.00	

	3	地下车库出入口抬头标识	2	面层 1.5mm 厚 304 不锈钢板激光切割造型，基础及装饰造型焊接，文字激光雕刻镂空内衬 5mm 厚亚克力，内置 LED 防水光源，内部钢架结构焊接，做环氧防锈底漆；整体做防锈底漆三遍，刮原子灰打磨至光滑程度，面饰品牌汽车漆两遍(木纹烤漆工艺处理及蓝色面漆处理)，背部采用不锈钢焊接底盒，做环氧防锈底漆；整体做防锈底漆三遍，刮原子灰打磨至光滑程度，面饰品牌汽车漆两遍，厚度 10 公分	6000*500		套	6365	12730.00	
	4	停车场指引牌	6	面层 1.5mm 厚 304 不锈钢板激光切割造型，基础及装饰造型焊接，文字激光雕刻镂空内衬 5mm 厚亚克力，内置 LED 防水光源，内部钢架结构焊接，做环氧防锈底漆；整体做防锈底漆三遍，刮原子灰打磨至光滑程度，面饰品牌汽车漆两遍(木纹烤漆工艺处理及蓝色面漆处理) 安装钢架基脚焊接，做防锈处理，整体厚度 10 公分。	900*2400		套	5605	33630.00	
二级导视	5	住院部电梯厅楼层号	19	1.5mm 厚 304 不锈钢激光切割造型焊接，整体做防锈底漆三遍，刮原子灰打磨至光滑程度，面饰品牌汽车漆两遍，木纹烤漆工艺处理及蓝色面漆处理，整体厚度 1.5cm。楼层水晶字数字厚度 1.5cm，信息内容采用 1.2mm 厚拉丝不锈钢粘贴 8mm 厚透明亚克力。挂墙安装，配备安装角码	3420*800		套	5220.40	99187.57	

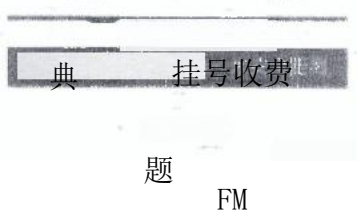
6	A 级 指引牌-中部走廊 (灯箱)	10	内部钢架结构焊接，做环氧防锈底漆，面层 1.2mm 厚 304 不锈钢板激光切割造型焊接，整体做防锈底漆三遍，刮原子灰打磨至光滑程度，面饰品牌汽车漆两遍，木纹烤漆工艺处理及蓝色部分不锈钢烤漆顶部弯折包裹及蓝色面漆处理，整体厚度 8 公分。图案 5mm 白色亚克力内容贴 3M 专用透光膜，做可活动更换插页，双面内容，内置蓝景 LED 光源，配备不锈钢丝杆吊杆件及 PVC 烤漆套管，顶置悬挂固定。	3050*430		套	5700	57000.00	
7	B 级 指引牌 - 两侧走廊 (灯箱)	9	内部钢架结构焊接，做环氧防锈底漆，面层 1.2mm 厚 304 不锈钢板激光切割造型焊接，整体做防锈底漆三遍，刮原子灰打磨至光滑程度，面饰品牌汽车漆两遍，木纹烤漆工艺处理及蓝色部分不锈钢烤漆顶部弯折包裹及蓝色面漆处理，整体厚度 8 公分。图案 5mm 白色亚克力内容贴 3M 专用透光膜，做可活动更换插页，双面内容，内置蓝景 LED 光源，配备不锈钢丝杆吊杆件及 PVC 烤漆套管，顶置悬挂固定。	1800*330		套	2660	23940.00	
8	电梯内部楼层索引	20	2mm 厚铝板激光切割造型，采用铝焊机激光焊接，整体做防锈底漆三遍，刮原子灰打磨至光滑程度，面饰品牌汽车漆两遍，木纹烤漆工艺处理及蓝色面漆处理，整体厚度 1.5cm。信息内容采用 5mm 厚透明亚克力导边背 UV 及双层亚克力插盒	1000*720		套	1615	32300.00	

				定制。挂墙安装，配备安装角码						
9	电梯号牌	96	1.5mm 厚 304 不锈钢激光切割造型焊接，整体做防锈底漆三遍，刮原子灰打磨至光滑程度，面饰品牌汽车漆两遍，木纹烤漆工艺处理及蓝色面漆处理，整体厚度 1.5cm。信息内容采用 5mm 厚透明亚克力导边背 UV。挂墙安装，配备安装角码	800*250	码中税	套	377.08	36200.10		
10	电梯厅入口处门楣	73	加厚背胶 UV 内容，覆亚膜保护	1600*300		套	58.9	4299.70		
11	楼梯间楼层号牌	62	1.5mm 厚 304 不锈钢激光切割造型焊接，整体做防锈底漆三遍，刮原子灰打磨至光滑程度，面饰品牌汽车漆两遍，木纹烤漆工艺处理及蓝色面漆处理，整体厚度 1.5cm。信息内容采用 5mm 厚透明亚克力导边背 UV。挂墙安装，配备安装角码	400*400		套	301.67	18703.39		
12	停车场内部导视(灯箱)	10	内部钢架结构焊接，做环氧防锈底漆，面层 1.2mm 厚 304 不锈钢板激光切割造型焊接，整体做防锈底漆三遍，刮原子灰打磨至光滑程度，面饰品牌汽车漆两遍，木纹烤漆工艺处理及蓝色部分不锈钢烤漆顶部	3050*430		套	5491	54910.00		

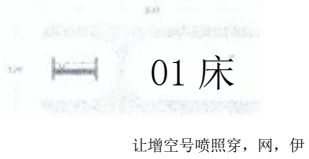
				弯折包裹及蓝色面漆处理，整体厚度 8 公分。图案 5mm 白色亚克力内容贴 3M 专用透光膜，做可活动更换插页，双面内容，内置蓝景 LED 光源，配备不锈钢丝杆吊杆件及 PVC 烤漆套管，顶置悬挂固定。						
13	住院部电梯号	266	1.5mm 厚 304 不锈钢激光切割造型焊接，整体做防锈底漆三遍，刮原子灰打磨至光滑程度，面饰品牌汽车漆两遍，木纹烤漆工艺处理及蓝色面漆处理，整体厚度 1.5cm。信息内容采用 5mm 厚透明亚克力导边背 UV。挂墙安装，配备安装角码	1000*250		套	471.36	125380.56		
14	住院部电梯厅楼层索引	87	1.5mm 厚 304 不锈钢激光切割造型焊接，整体做防锈底漆三遍，刮原子灰打磨至光滑程度，面饰品牌汽车漆两遍，木纹烤漆工艺处理及蓝色面漆处理，整体厚度 1.5cm。楼层水晶字数字厚度 1.5cm，信息内容采用 5mm 厚透明亚克力导边背 UV。挂墙安装，配备安装角码	720*1400		套	1890.5	164473.50		
15	停车场出口牌	20	面层 1.5mm 厚 304 不锈钢板激光切割焊接双面造型，做环氧防锈底漆；整体做防锈底漆三遍，刮原子灰打磨至光滑程度，面饰品牌汽车漆两遍(木纹烤漆工艺处理及蓝色面漆处理)整体厚度 3 公分，表面内容贴 III 类工程反光膜	1200*486		套	950	19000.00		

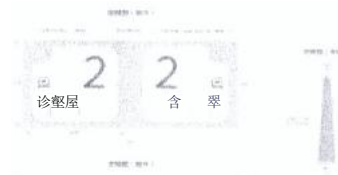
三级导视	16	科室牌一楼·抢救室	3	1.5mm厚304不锈钢激光切割造型焊接,整体做防锈底漆三遍,刮原子灰打磨至光滑程度,面饰品牌汽车漆两遍,木纹烤漆工艺处理及蓝色面漆处理,整体厚度1.5cm。信息内容采用5mm厚透明亚克力导边背UV。挂墙安装,配备安装角码	4050*630		套	5510	16530.00	
	17	科室灯箱(贴墙式)	4	面层1.5mm厚304不锈钢板激光切割造型,基础及装饰造型焊接,镂空内衬5mm厚亚克力,内容贴3M专用透光膜,内置LED防水光源,做环氧防锈底漆;整体做防锈底漆三遍,刮原子灰打磨至光滑程度,面饰品牌汽车漆两遍(木纹烤漆工艺处理干净整洁),背部采用不锈钢焊接底盒,做环氧防锈底漆;整体做防锈底漆三遍,刮原子灰打磨至光滑程度,面饰品牌汽车漆两遍,厚度6公分挂墙安装,配备安装角码	2000*250		套	1346.47	5385.87	
	18	护士站牌(灯箱)	26	内部钢架结构焊接,做环氧防锈底漆,面层1.2mm厚304不锈钢板激光切割造型焊接,整体做防锈底漆三遍,刮原子灰打磨至光滑程度,面饰品牌汽车漆两遍,木纹烤漆工艺处理及蓝色部分不锈钢烤漆顶部弯折包裹及蓝色面漆处理,整体厚度8公分。图案5mm白色亚克力内容贴3M专用透光膜,做可活动更换插页,双面内容,内置蓝景LED光源,配备不锈钢丝杆吊杆件及	1500*330		套	1900	49400.00	


				PVC 烤漆套管，顶置悬挂固定。						
19	住院部病房号指引牌(灯箱)	38	内部钢架结构焊接，做环氧防锈底漆，面层 1.2mm 厚 304 不锈钢板激光切割造型焊接，整体做防锈底漆三遍，刮原子灰打磨至光滑程度，面饰品牌汽车漆两遍，木纹烤漆工艺处理及蓝色部分不锈钢烤漆顶部弯折包裹及蓝色面漆处理，整体厚度 8 公分。图案 5mm 白色亚克力内容贴 3M 专用透光膜，做可活动更换插页，双面内容，内置蓝景 LED 光源，配备不锈钢丝杆吊杆件及 PVC 烤漆套管，顶置悬挂固定。	1700*270		套	2280	86640.00		
20	就诊等候区（灯箱）	6	内部钢架结构焊接，做环氧防锈底漆，面层 1.2mm 厚 304 不锈钢板激光切割造型焊接，整体做防锈底漆三遍，刮原子灰打磨至光滑程度，面饰品牌汽车漆两遍，木纹烤漆工艺处理及蓝色部分不锈钢烤漆顶部弯折包裹及蓝色面漆处理，整体厚度 8 公分。图案 5mm 白色亚克力内容贴 3M 专用透光膜，做可活动更换插页，双面内容，内置蓝景 LED 光源，配备不锈钢丝杆吊杆件及 PVC 烤漆套管，顶置悬挂固定。	1560*300		套	1900	11400.00		



	21	科室详牌	10	1.5mm厚304不锈钢激光切割造型焊接，整体做防锈底漆三遍，刮原子灰打磨至光滑程度，面饰品牌汽车漆两遍，木纹烤漆工艺处理及蓝色面漆处理，整体厚度1.5cm。信息内容采用5mm厚透明亚克力导边背UV。挂墙安装，配备安装角码	400*800		套	603.34	6033.35	
	22	科室门牌	29	1.5mm厚304不锈钢激光切割造型焊接，整体做防锈底漆三遍，刮原子灰打磨至光滑程度，面饰品牌汽车漆两遍，木纹烤漆工艺处理及蓝色面漆处理，整体厚度1.5cm。信息内容采用5mm厚透明亚克力导边背UV。挂墙安装，配备安装角码	1500*340	黑 综合诊区... 血	套	961.57	27885.39	
	23	科室牌 (小型)	10	1.5mm厚304不锈钢激光切割造型焊接，整体做防锈底漆三遍，刮原子灰打磨至光滑程度，面饰品牌汽车漆两遍，木纹烤漆工艺处理及蓝色面漆处理，整体厚度1.5cm。信息内容采用5mm厚透明亚克力导边背UV。挂墙安装，配备安装角码	1200*340	病理科会诊室	套	769.25	7692.52	
	24	大厅挂号 收费窗口	3	背胶，亚克力导边反面UV，厚度3mm	6700*1500		套	1507.5	4522.50	

	25	窗口贴	10	加厚背胶 UV 内容，覆亚膜保护	1000*300		个	19.95	199.50	
四级导视	26	卫生间门牌 (侧贴式)	21	2mm 厚铝板激光切割造型，采用铝焊机激光焊接，整体做防锈底漆三遍，刮原子灰打磨至光滑程度，面饰品牌汽车漆两遍，木纹烤漆工艺处理，整体厚度 5cm。双面信息内容采用 5mm 厚透明亚克力导边背 UV 底喷白。挂墙安装，开葫芦孔	280*250 (单面)		套	280	5880.00	
	27	卫生间门牌 (背贴式)	458	1.5mm 厚 304 不锈钢激光切割造型焊接，整体做防锈底漆三遍，刮原子灰打磨至光滑程度，面饰品牌汽车漆两遍，木纹烤漆工艺处理及蓝色面漆处理，整体厚度 1.5cm。信息内容采用 5mm 厚透明亚克力导边背 UV。挂墙安装，配备安装角码	270*250		套	140	64120.00	
	28	办公室门牌 (背贴式)	510	1.5mm 厚 304 不锈钢激光切割造型焊接，整体做防锈底漆三遍，刮原子灰打磨至光滑程度，面饰品牌汽车漆两遍，木纹烤漆工艺处理及蓝色面漆处理，整体厚度 1.5cm。信息内容采用 5mm 厚透明亚克力导边背 UV。挂墙安装，配备安装角码	300*150	医生办公室	套	93.33	47600.00	

29	手术室门牌(背贴式)	18	1.5mm 厚 304 不锈钢激光切割造型焊接, 整体做防锈底漆三遍, 刮原子灰打磨至光滑程度, 面饰品牌汽车漆两遍, 木纹烤漆工艺处理及蓝色面漆处理, 整体厚度 1.5cm。信息内容采用 5mm 厚透明亚克力导边背 UV。挂墙安装, 配备安装角码	250*550		套	285.19	5133.33	
30	设备间铭牌	630	304 拉丝不锈钢面板, 厚度 1.2mm, 丝网印刷, 不锈钢表面做无指纹处理	100*100		个	22.8	14364.00	
31	病房床号牌	340	铝板底板, 表面木纹工艺, 厚度 1.5mm, 亚克力反面 UV, 厚度 5mm, 内胆上下侧木芯纹贴膜	280*250 (单面)		套	280	95200.00	
32	病房床头牌	1014	亚克力整面反面 UV, 厚度 3mm	300*120		套	18.28	18535.80	
33	电梯间门牌(侧贴式)	58	2mm 厚铝板激光切割造型, 采用铝焊机激光焊接, 整体做防锈底漆三遍, 刮原子灰打磨至光滑程度, 面饰品牌汽车漆两遍, 木纹烤漆工艺处理, 整体厚度 5cm。双面信息内容采用 5mm 厚透明亚克力导边背 UV	280*250 (单面)		套	280	16240.00	

				底喷白。挂墙安装，开葫芦孔						
34	诊室号牌 (侧贴式)	63	2mm 厚铝板激光切割造型，采用铝焊机激光焊接，整体做防锈底漆三遍，刮原子灰打磨至光滑程度，面饰品牌汽车漆两遍，木纹烤漆工艺处理，整体厚度 5cm。双面信息内容采用 5mm 厚透明亚克力导边背 UV 底喷白。挂墙安装，开葫芦孔	280*250 (单面)		套	280	17640.00		
35	节约用水 提示牌	700	亚克力激光切割导边，整面反面 UV 底部喷白，厚度 3mm	100*100(正 圆)		套	20.31	14217.69		
36	禁烟标识	600	亚克力激光切割导边，整面反面 UV 底部喷白，厚度 3mm	210*294		套	31.35	18810.00		

37	电 梯 提 示 贴	30	背胶 UV 内容，覆亚膜保护	400*130 (单个)		套	3.46	103.74	
38	玻 璃 防 撞 条	500	背胶 UV 内容，覆亚膜保护	1000*110		m	7.32	3657.50	
39	消 防 疏 散 图	100	底板亚克力激光切割导边，整面反面 UV 底部喷白，厚度 5mm 面层亚克力激光切割导边，整面反面 UV 底部喷白，厚度 3mm	400*250		套	63.55	6355.17	
40	淋浴间	453	亚克力激光切割导边，整面反面 UV 底部喷白，厚度 3mm	100*100 (正圆)		套	20.31	9200.87	

	41	随 手 关 灯 提示 牌	1500	亚克力激光切割导边，整面反面 UV 底部喷白，厚度 3mm	100*30		套	7.69	11529.00	
	42	空 调 温 度 提示 牌	1500	亚克力激光切割导边，整面反面 UV 底部喷白，厚度 3mm	100*35		套	7.69	11529.00	
	43	发 光 指 引 (贴 墙 式)	30	表面 304 不锈钢拉丝面板，厚度 1.5mm, 字体整体深度 50mm, 同 材质不锈钢弯折内置高亮冷白光 (6000k) LED 灯，背板发光面 5mm 亚克力	1000*1000		套	1350.00	40500.00	
44		科室宣传 栏	24	金属框架底板采用 2mm 镀锌板折 边，表面烤白漆。木纹饰面板 1 块， 材质为不锈钢，表面木纹烤漆。安 装角阀配件为不锈钢材质角阀。发 光院徽直径 270mm, 采用亚克力无 边框灯箱结构。呼吸灯版块尺寸为 0.45m×0.45m, 采用 0.12cm 厚不锈 钢折边烤漆面板，内嵌亚克力面板， 底部内嵌呼吸灯带，含呼吸灯控制 器。装饰线条尺寸为 0.6m×0.2m, 采用 2mm 带胶亚克力雕刻。 科室历史栏采用 0.3cm 亚克力板， 背面 UV 打印。科室标题单字尺寸 为 0.15m×0.15m, 采用不锈钢面板	4800*1200		套	10562.23	253493.58	

				水晶字。科室介绍栏标题采用不锈钢面板水晶字。医生护士一览表采用 7mm PVC 盖板加 2mm 亚克力面板结构，双层磁吸贴。 科室简介均采用亚克力面板、PVC 垫底、双面磁吸结构，底部绕灯带。装饰蓝色长条采用 3.3cm PVC 底板，表面覆 2mm 带胶亚克力饰面，内藏中性光灯带。 背部开口穿线设计用于院区壁挂电视机支架安装，上下部分内嵌灯带及呼吸灯模组藏线，长度 2.5m, 电线 150m(米数按现场实际)。变压器为 200W, 品牌包括明纬、德力西、威震等同类产品。轨道射灯功率为 30W, 品牌包括欧普、雷士、飞利浦等同类产品。射灯轨道系统满足设计要求，品牌同上，含制作安装及辅材费用。包含文字内容排版、医护人员照片精修等设计深化服务，费用为总价包干。					
	合计							1594936.34	
注：单价包括税金、设计、零配件材料、安装、辅材等所有费用。									

(二)项目实施标准及要求

1. 施工及安全责任

供应商应对本项目施工及项目所有设施的安全承担全部责任，确保施工过程安全、合规，不影响场地正常使用。

2. 安装与精度要求

所有标识牌应按图施工，安装位置准确，误差控制在合理范围($\pm 5\text{ mm}$)，并确保安装牢固、美观、无松动、无翘边、无明显倾斜。

3. 深化设计与材料确认

施工前，投标人须提交施工深化方案、结构方案及实际产品样图，须经采购人确认后方可实施制作与安装。

执行标准参考

4. 本项目标识系统参照下列国家标准进行设计与验收：

GB/T10000《标识及信息导向系统术语》

GB/T20501《公共信息导向系统要素的设计原则与要求》

GB/T15566《公共信息导向系统设置原则与要求》

5. 材料及工艺要求

(1) 标牌面板材质

而板采用 3003、5052 或 6061 系列铝板，厚度不小于 2.0mm；根据具体应用可采用铝塑板、亚克力板等具备一定耐候性能的材料。

(2) 结构件选材

支撑结构及立柱建议采用 Q235 钢材，结构牢固，表面平整，无明显锈蚀、裂纹等缺陷。

(3) 防腐处理

钢结构件建议采用电镀锌或喷锌处理(如为户外长期使用可采用热浸锌处理)，锌层厚度符合行业标准，涂层完整、无漏喷现象。

(4) 焊接与连接

焊接部位牢固，无明显焊瘤、气孔，连接件采用不锈钢或镀锌螺丝，紧固可靠，接口过渡自然。

(5) 表面处理

面板表面应颜色均匀，图文清晰，喷涂或丝印无掉漆、起皮、污渍，边缘整齐无毛刺，整体视觉效果良好。

(6) 安装标准

安装后标识应垂直、平整、无明显歪斜。所有图文、图标布局合理，间距匀称，符合导视系统美观性原则。

(7) 耐候性能

户外标识应选用具备防水、防晒、防潮的材料及工艺，确保长期使用不褪色、不变形、不生锈，使用寿命不少于 3 年。

6. 原材料参数要求

名称	参数要求
亚克力板	须满足 GB/T7134-2008 标准，板材的表面平滑。板材中未发现大于 3mm 的划痕、斑点或其他表面缺陷；颜色分布均匀，色泽一致。拉伸断裂应变的范围 $\geq 3\%$ ，拉伸弹性模量的范围 $\geq 4000\text{MPa}$ 。
PVC 发泡板	须满足 GB/T1033.1-2008 标准，颜色均匀，样品表面无气泡，无裂无明显裂纹，无凹陷，无杂质，密度 $< 600\text{kg/m}^3$ 的
铝单板	须满足 GB/T23443-2009 标准，板材边部切齐无毛刺、裂边板材无开焊等。外观整洁，色泽基本一致，无明显划伤。装饰面无明显压痕、印痕和凹凸等残迹。无明显色差。涂层无流痕、裂纹、气泡、夹杂物和其他表面缺陷，铅笔硬度 $\geq 1.5\text{H}$ ，耐磨性 $\geq 3\text{L}\mu\text{m}$ 。
锌黄环氧漆	须满足 GB/T26125-2011、GB/T29786-2013 标准，铅 $< 80\text{mg/kg}$ 、镉 $< 80\text{mg/kg}$ 、六价铬 $< 80\text{mg/kg}$ 、汞 80mg/kg

10.响应偏离文件

10.1 技术需求响应/偏离表

序号	采购/调研文件条 目号	采购/调研文件技术需求	投标技术响应	响应/偏离	说明

--	--	--	--	--	--

注： 1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在采购/调研文件中（或页码）的依据；

2、投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担。

投标人盖章：

法定代表人或委托代理人签字或签章：

10.2 商务条件响应/偏离表

序号	采购/调研文件条 目号	采购/调研文件的商务条件	投标文件的商务响应	响应/偏离	说明

注： 1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在采购/调研文件中（或页码）的依据；
2、投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担。

投标人盖章：
法定代表人或委托代理人签字或签章：

注：以下非正文，可删除

文件编制补充说明

可收费耗材：
需提供

1. 江西省药品和医用耗材招采管理系统（网址：<https://ggfw.ybj.jiangxi.gov.cn/#/Index>）截图示例，其中框出内容为截图必含项，截图内信息需清晰可辨认。

江西省

药品和医用耗材招采管理系统

工作台

目录管理

挂网目录查询

院内目录管理

自主议价管理

采购计划管理

收货退货管理

采购评价

采购订单管理

业务办理管理

报量项目管理

交易数据综合查询(耗材)

人工关节组套-挂网目录查询

结算申请管理

结算账户管理

结算支付

三方协议管理(医疗机构)

短缺信息/备采采购管理

人工关节组套-目录管理

人工关节组套-议价管理

人工关节组套-采购计划管理

人工关节组套-订单管理

人工关节组套-退货管理

挂网目录查询

耗材统一编码 请输入

产品名称 请输入

注册证编号 请输入

注册证名称 请输入

型号 请输入

规格 请输入

包装 请输入

生产企业 请输入

展开

重置

查询

注意：国家组织人工关节带量目录查询请至“人工关节组套-目录管理”中进行查看。

批量添加到院内目录

序号	项目名称	产	注册证编号	注册证名称	型号	规格	包装	包	生产企业	代	注册证有效期止	挂网价(元)	类	质	挂网状态	耗	挂网ID	操作
1	广东集采新冠检测相关耗材	核...	粤深械备20220425	核酸提取或纯化试剂	H3-10	24测试/盒	24测试/盒	纸质	深圳市汇松科技发展有限公司	深...	2099-12-31	39.60			已挂网	C1...	111202022908190	查看详情 添加到院内目录
2	广东集采新冠检测相关耗材	核...	粤深械备20220425	核酸提取或纯化试剂	H3-10	12测试/盒	12测试/盒	纸质	深圳市汇松科技发展有限公司	深...	2099-12-31	19.80			已挂网	C1...	111202022908189	查看详情 添加到院内目录
3	广东集采新冠检测相关耗材	核...	粤深械备20220425	核酸提取或纯化试剂	H3-10	32测试/盒	32测试/盒	纸质	深圳市汇松科技发展有限公司	深...	2099-12-31	52.80			已挂网	C1...	111202022908188	查看详情 添加到院内目录
4	广东集采新冠检测相关耗材	核...	粤深械备20220425	核酸提取或纯化试剂	H3-10	16测试/盒	16测试/盒	纸质	深圳市汇松科技发展有限公司	深...	2099-12-31	26.40			已挂网	C1...	111202022908187	查看详情 添加到院内目录
5	广东集采新冠检测相关耗材	核...	粤深械备20220425	核酸提取或纯化试剂	H3-10	48测试/盒	48测试/盒	纸质	深圳市汇松科技发展有限公司	深...	2099-12-31	79.20			已挂网	C1...	111202022908186	查看详情 添加到院内目录
6	广东集采新冠检测相关耗材	核...	粤深械备20220425	核酸提取或纯化试剂	H3-10	8测试/盒	8测试/盒	纸质	深圳市汇松科技发展有限公司	深...	2099-12-31	13.20			已挂网	C1...	111202022908185	查看详情 添加到院内目录
7	广东集采新冠检测相关耗材	核...	粤深械备20220425	核酸提取或纯化试剂	H3-10	96测试/盒	96测试/盒	纸质	深圳市汇松科技发展有限公司	深...	2099-12-31	158.40			已挂网	C1...	111202022908184	查看详情 添加到院内目录
8	广东集采新冠检测相关耗材	核...	粤深械备20220425	核酸提取或纯化试剂	H3-10	50测试/盒	50测试/盒	纸质	深圳市汇松科技发展有限公司	深...	2099-12-31	332.50			已挂网	C1...	111202022908183	查看详情

共2379130条 显示1-10条

1 2 3 4 5 6 ... 237913 10条/页 跳转至第 页

2. 国家医保信息业务编码标准数据库动态维护官网（网址：<https://code.nhsa.gov.cn/toSearch.html?sysflag=1004>）截图示例，其中框出内容为截图必含项，截图内信息需清晰可辨认。

国家医保信息业务编码标准数据库动态维护

医用耗材分类目录

医用耗材信息

医用耗材代码：

一级分类：

注册证号：

医保通用名：

管

二级分类：

耗材企业：

三级分类：

规格型号

注册备案号：

型号：

单件产品名称：

规格：

Q 查询

— 重置

	注册备案号 注册备案产品名称	医保耗材分类编码	注册、备案人	单件产品名称	企业名称	规格	型号	UC
1	国械注进20223090144 一次性使用经支气管内窥镜热蒸汽汽治...	C0101040040000103588 0000001 非血管介入治疗类材料/呼吸...	爱普可医疗有 限公司 Uptak e Medical B. V.	一次性使用经支气管 内窥镜热蒸汽治疗导 管	杭州蓝博生物科技有 限公司	UM-CTH-100	UM-CTH-100	

首页上一页

1

共 1 页

下一页尾页

25

1 - 1 共 1 条

医用耗材代码	一级分类 (学科、品类)	耗材企业	操作
1 C0101040040000103588	非血管介入治疗类材料	杭州蓝博生物科技有限公司	详情
2 C0101040040000311325	非血管介入治疗类材料	波科国际医疗贸易 (上海) 有限公司	详情
3 C0101110090000007834	非血管介入治疗类材料	奥林巴斯贸易 (上海) 有限公司	详情
4 C0101110090000008041	非血管介入治疗类材料	江苏唯德康医疗科技有限公司	详情
5 C0101110090000008929	非血管介入治疗类材料	上海埃尔德医疗器械有限公司	详情
6 C0101120100000004937	非血管介入治疗类材料	南通圣学科技股份有限公司	详情
7 C0101120100000012308	非血管介入治疗类材料	江苏格莱特医疗科技有限公司	详情
8 C0101120100000015753	非血管介入治疗类材料	新光维医疗科技 (苏州) 股份有限公司	详情
9 C0101170150000003588	非血管介入治疗类材料	杭州蓝博生物科技有限公司	详情
10 C0101170150000012066	非血管介入治疗类材料	湖南朗开医疗科技有限公司	详情
11 C0101230040000000095	非血管介入治疗类材料	江苏省永宁医疗器械有限公司	详情
12 C0101230040000000729	非血管介入治疗类材料	茂名市德力康医疗科技有限公司	详情
13 C0101230040000000931	非血管介入治疗类材料	河南三耀医疗器械有限公司	详情
14 C0101230040000001682	非血管介入治疗类材料	广州维力医疗器械股份有限公司	详情
15 C0101230040000002192	非血管介入治疗类材料	江苏华宏医疗器械有限公司	详情

国家医疗保障局

关于本网

网站声明

联系我们

版权所有：国家医疗保障局

京ICP备19000471号-1

京公网安备11010202000007号

政府网站标识码：bm83000001

地址：北京市西城区月坛北小街2号

政府网站

找错

不可收费耗材：
需提供

1. 江西省药品和医用耗材招采管理系统（网址：<https://ggfw.ybj.jiangxi.gov.cn/#/Index>）截图示例，其中框出内容为截图必含项，截图内信息需清晰可辨认。

江西省

药品和医用耗材招采管理系统

工作台

目录管理

挂网目录查询

院内目录管理

自主议价管理

采购计划管理

收货退货管理

采购评价

采购订单管理

业务办理管理

报量项目管理

交易数据综合查询（耗材）

人工关节组套-挂网目录查询

结算申请管理

结算账户管理

结算支付

三方协议管理(医疗机构)

短缺信息/备案采购管理

人工关节组套-目录管理

人工关节组套-议价管理

人工关节组套-采购计划管理

人工关节组套-订单管理

人工关节组套-退货管理

首页

您好

南昌大学第二附属医院2

退出

挂网目录查询

耗材统一编码 请输入

产品名称 请输入

注册证编号 请输入

注册证名称 请输入

型号 请输入

规格 请输入

包装 请输入

生产企业 请输入

展开

重置

查询

注意：国家组织人工关节带量目录查询请至“人工关节组套-目录管理”中进行查看。

批量添加到院内目录

序号	项目名称	产	注册证编号	注册证名称	型号	规格	包装	包	生产企业	代	注册证有效期止	挂网价(元)	类	质	挂网状态	耗	挂网ID	操作
1	广东集采新冠检测相关耗材	核...	粤深械备20220425	核酸提取或纯化试剂	H3-10	24测试/盒	24测试/盒	纸质	深圳市汇松科技发展有限公司	深...	2099-12-31	39.60			已挂网	C1...	111202022908190	查看详情 添加到院内目录
2	广东集采新冠检测相关耗材	核...	粤深械备20220425	核酸提取或纯化试剂	H3-10	12测试/盒	12测试/盒	纸质	深圳市汇松科技发展有限公司	深...	2099-12-31	19.80			已挂网	C1...	111202022908189	查看详情 添加到院内目录
3	广东集采新冠检测相关耗材	核...	粤深械备20220425	核酸提取或纯化试剂	H3-10	32测试/盒	32测试/盒	纸质	深圳市汇松科技发展有限公司	深...	2099-12-31	52.80			已挂网	C1...	111202022908188	查看详情 添加到院内目录
4	广东集采新冠检测相关耗材	核...	粤深械备20220425	核酸提取或纯化试剂	H3-10	16测试/盒	16测试/盒	纸质	深圳市汇松科技发展有限公司	深...	2099-12-31	26.40			已挂网	C1...	111202022908187	查看详情 添加到院内目录
5	广东集采新冠检测相关耗材	核...	粤深械备20220425	核酸提取或纯化试剂	H3-10	48测试/盒	48测试/盒	纸质	深圳市汇松科技发展有限公司	深...	2099-12-31	79.20			已挂网	C1...	111202022908186	查看详情 添加到院内目录
6	广东集采新冠检测相关耗材	核...	粤深械备20220425	核酸提取或纯化试剂	H3-10	8测试/盒	8测试/盒	纸质	深圳市汇松科技发展有限公司	深...	2099-12-31	13.20			已挂网	C1...	111202022908185	查看详情 添加到院内目录
7	广东集采新冠检测相关耗材	核...	粤深械备20220425	核酸提取或纯化试剂	H3-10	96测试/盒	96测试/盒	纸质	深圳市汇松科技发展有限公司	深...	2099-12-31	158.40			已挂网	C1...	111202022908184	查看详情 添加到院内目录
8	广东集采新冠检测相关耗材	核...	粤深械备20220425	核酸提取或纯化试剂	H3-10	50测试/盒	50测试/盒	纸质	深圳市汇松科技发展有限公司	深...	2099-12-31	332.50			已挂网	C1...	111202022908183	查看详情

共2379130条 显示1-10条

1 2 3 4 5 6 ... 237913 > 10条/页 跳转至第 页